



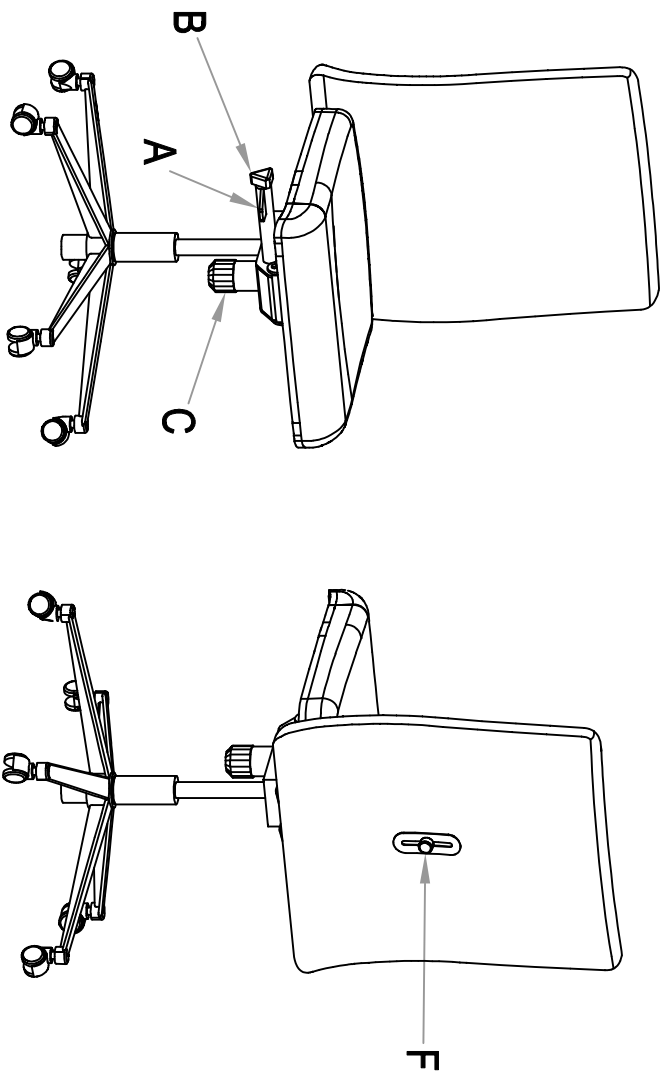

565-07X-XXX / 11-2020

SMART

Κάθισμα εργασίας με μηχανισμό Synchro
Working chair with a Synchro mechanism

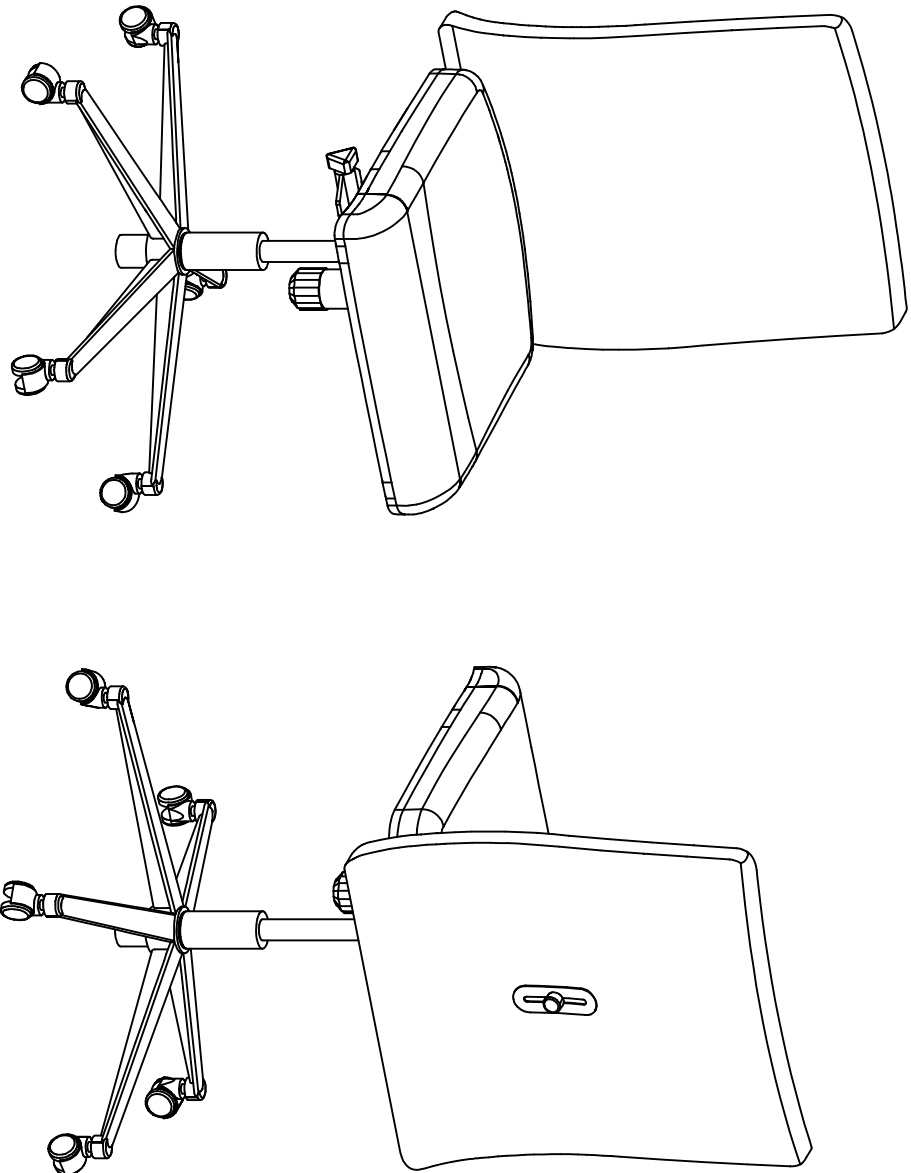

Ρύθμιση ύψους της έδρας

Για να ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος αναζητήστε τα πτερύγια του μοχλού (A) κάτω και δεξιά από την έδρα του καθίσματος. Ενώ είστε καθισμένοι, πιέστε προς τα εμπρός το πτερύγιο για να χαμηλώσετε το ύψος του καθίσματος. Για να υψώσετε το κάθισμα, ανασηκωθείτε και επαναλάβετε την κίνηση.

Seat height adjustment

For adjustment of the seat height, find the flaps on the handle (A) underneath the right side of the seat. While seated push the flap onwards to lower the seat height. To raise the seat, get up and repeat the above procedure.

Ρύθμιση κλίσης της πλάτης

Υπάρχουν έως πέντε διαφορετικές θέσεις ανάκλισης έδρας - πλάτης. Για να επιλέξετε την επιθυμητή κλίση αναζητήστε το στροφέο (B) κάτω και δεξιά από την έδρα του καθίσματος. Γυρίστε το προς τα εμπρός μία φορά για να ξεκλειδώσει η πλάτη. Πιέτε το βάρος σας προς τα πίσω, βρείτε τη θέση που σας βολεύει και ξαναγυρίστε το στροφέο (B) προς τα εμπρός, άλλη μία φορά για να κλειδώσει στη θέση που επιθυμείτε. Έχοντας ξεκλειδώσει την έδρα - πλάτη μπορείτε να αλλάξετε την κλίση με την πίεση του σώματός σας. Η σκληρότητα της ανάκλισης έδρας - πλάτης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του χρήστη μέσω του στροφέου (C) που βρίσκεται κάτω από την έδρα.

Tilt adjustment of the backrest

There are up to five different positions for a seat - back reclination. To choose the desired position, find the crank (B) beneath the seat, at the right side. Turn clockwise once to unlock the backrest. Move your weight backwards, find a convenient position and then turn the crank (B) clockwise, once again, to lock in the desired position. Having unlocked the seat and the back, you can change the position using the pressure of your body. The hardness of the tilt of the seat and back can be adjusted depending on the user's weight through the crank (C) which is located below the seat.

Υποστήριξη οσφυϊκών σπονδύλων

Στην πίσω πλευρά της πλάτης του καθίσματος βρίσκεται ο μοχλός F. Για να ενισχύσετε τη στήριξη των οσφυϊκών σπονδύλων κινείτε άνω και κάτω το μοχλό F μέχρι να φτάσει το ανατομικό μοχλάκι στο επιθυμητό σημείο.

Support of the lumbar vertebra


On the rear side of the chair's back, there is the lever F. In order to enhance the lumbar support, move the lever F up and down until the anatomical cushion reaches the desired position.



ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.62121, ΣΕΡΡΕΣ / Τ. 23210 99220 / Φ. 23210 99270


PLANT: INDUSTRIAL AREA OF SERRES, 62121, SERRES, GREECE / Τ. +30 23210 99220 / Φ. +30 23210 99270
www.dromeas.gr / e-mail:dromeas@dromeas.gr / 801 11 96000 (αγοική Χρέωση)

1 Σύνδεση πλάτης με έδρα / Connecting seat and back

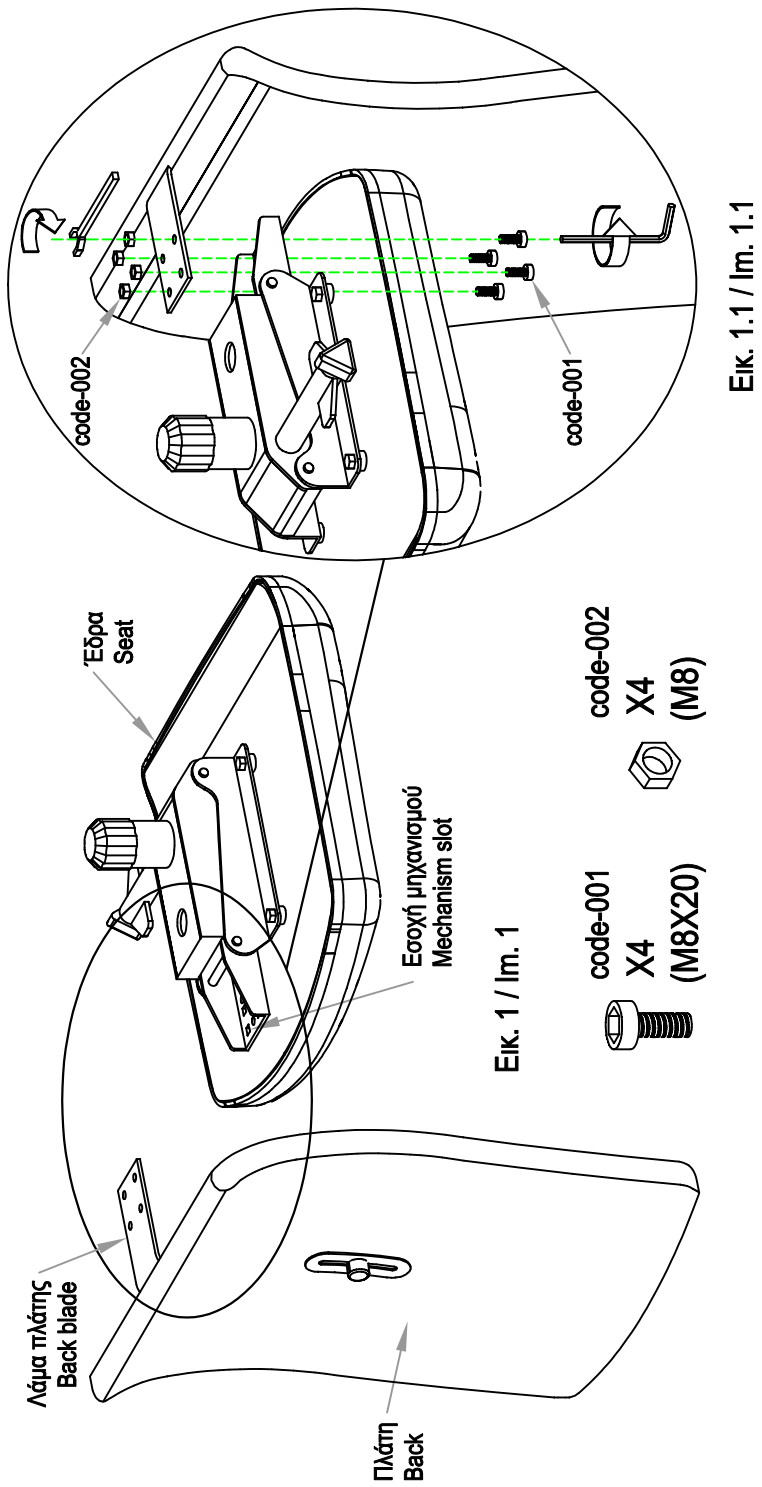

Αρχικά γυρίζουμε την έδρα ανάποδα. Έπειτα τοποθετούμε την λάμα της πλάτης στην εσοχή του μηχανισμού και βιδώνουμε όπως απεικονίζεται στην Εικ. 1.1.
First we turn the seat upside-down. Then we insert the back blade in the mechanism slot and screw as seen in the Im. 1.1.


2 Τοποθέτηση εμβόλου στο πεντάνευρο / Placing the piston on the base

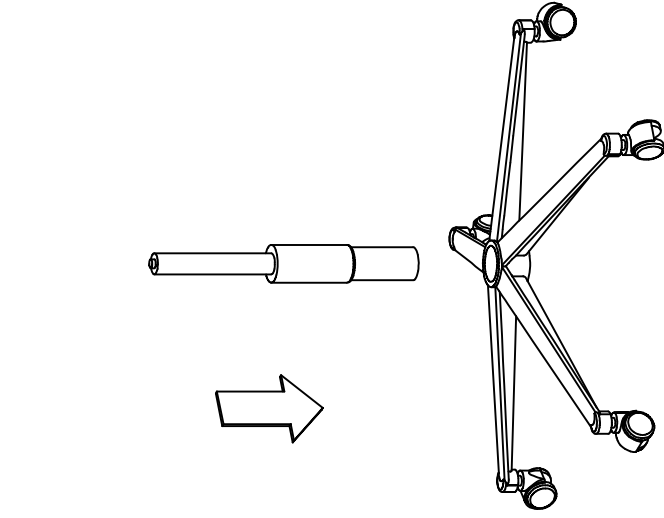

Πεντάνευρο / Five-star base
1 τεμάχιο
1 piece

Έδρα / Seat
1 τεμάχιο
1 piece

3 Σύνδεση έδρας με έμβολο / Connecting the seat with the piston

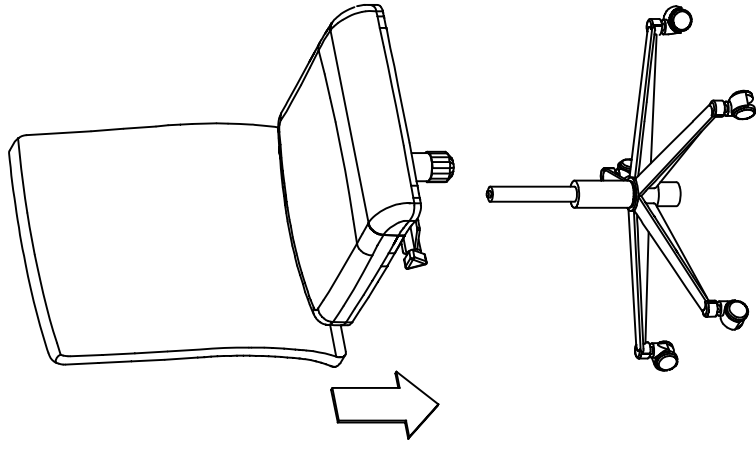

Καθόμαστε με δύναμη για να κουμπώσει ο μηχανισμός
Seat with force in order to place the mechanism.